


**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA**

im. dr Konrada Vietha w Radomiu

26-600 Radom ul. B. Limanowskiego 42

Regon: 000303060 NIP: 948-16-24-611



Telefony: *Dyrektor:* 048-362 62 76
Centrala: 048-362 11 27
Tel./fax: 048-362 62 76

e-mail: dyrektor@rckik.radom.pl
e-mail: przetargi@rckik.radom.pl

Radom, dnia 26.07.2016r.

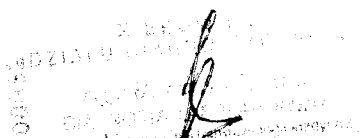
Dotyczy: Sprawy nr NA-ZP-250/04/04/16, pakietu nr 1 - Zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej

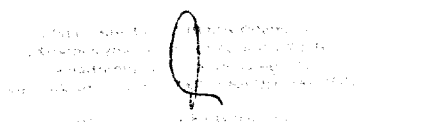
W odpowiedzi na pismo PZ CORMAY S.A. z dnia 20.07.2016r. informujemy co następuje:

Podtrzymujemy nasze wszystkie zastrzeżenia dotyczące jakości oferowanych przez Państwa firmę wyrobów.

1. Zaproponowane przez Państwa próbówki do wykonywania badań metodami biologii molekularnej posiadają korki o różnych kolorach (biały i fioletowy), co jest niezgodne z norma ISO 6710.
2. Uważamy, że nie ma możliwości usunięcia igły motylkowej z żyły dawcy bez użycia drugiej ręki. Druga ręka służy nie tylko do przytrzymania motylka, ale również (i przede wszystkim), do zabezpieczenia miejsca wkłucia przy pomocy wacika.
3. Według naszej oceny igła motylkowa nie posiada mechanizmu samoczynnego usunięcia ostrza z żyły i schowania w osłonce. Mechanizm samoczynnego usunięcia ostrza z żyły powinien odbywać się automatycznie. W tym przypadku wymagane jest działanie operatora polegające na wysunięciu igły z naczynia i dopiero w trakcie tej czynności igła chowa się w osłonce.

Podtrzymujemy wybór Wykonawcy przedmiotu zamówienia : Proplasma sp. z o.o.


26.07.2016


26.07.2016